

Manuale di uso e manutenzione del sistema automatico di registrazione di temperatura
approvato con D.M. 8 /7/1997 n° 552138 e successive modifiche
Conforme alla norma EN-12830

REC96-20083



**Manuale non
riproducibile**

Nota introduttiva

ATTENZIONE: Questo manuale è da ritenersi parte integrante del termo-registratore REC96-20083 ed il Costruttore ne raccomanda la conservazione a bordo dell'automezzo. In caso di smarrimento o furto, l'utente può contattare la ditta costruttrice o il concessionario autorizzato per provvedere all'immediata sostituzione. La mancanza del manuale o la non osservanza delle regole imposte dal suddetto, può invalidare la garanzia sul prodotto.

Lo scopo di questo manuale è quello di preparare l'utente all'uso corretto dello strumento e delle eventuali periferiche collegate. In esso sono contenute anche le istruzioni da osservare per una corretta installazione ed una regolare manutenzione e/o revisione periodica come imposto dalla norma EN13486. Le informazioni di questo manuale sono brevi e chiare, per questo, il Costruttore ne consiglia una attenta lettura prima dell'uso onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Il termo-registratore REC96-20083 è certificato secondo:

- EN 12830 : Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e gelati. Prove prestazioni ed impiego.

Il termo-registratore REC96-20083 è conforme a:

- EN 13486 : Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e gelati. Verifiche periodiche



Caratteristiche metrologiche

Tensione di alimentazione	90/32	VDC
Corrente assorbita (non in stampa a V=12,6)	40	mA
Corrente assorbita (media in stampa a V=12,6)	350	mA
Corrente assorbita (picco in stampa a V=12,6 - densità 50 %)	0,8	A
Velocità di stampa	2	lps
Sonde collegabili (mod. PT100 a 3 fili)	3	
Display LCD retroilluminato	12 x 3	carat.
Intervallo di registrazione (preimpostato a 15 min.)	1, 5, 10, 15, 20, 30, 60	min
Memoria	32000 x 2	byte
Campo di misura	-59.5 / +59.5	°C
Risoluzione	0.1	°C
Divisione visualizzata e memorizzata	0.5	°C
Esattezza (da -30 a + 30 °C)	± 0.5	°C
Classe di accuratezza	1	
Soglia allarme termostati (preimpostata a -15°C)	-59 / +59	°C
Ritardo attivazione allarme termostati (preimpostato a 10 sec.)	0/600	sec.
Esattezza orologio	< 0.004	%
Tempo di risposta	120	sec.
Campo di utilizzo	- 40 / + 80	°C
Grado di protezione SON96V.0 (associata)	68	IP
	Mod. C	Mod. E
Grado di protezione REC96-20083	40	65
Dimensione	186 x 56 x 113	230 x 200 x 117
Peso (confezione standard)	2400	2700
		g

Istruzioni necessarie all'uso

1 - Introduzione	5
2 – Panoramica ed installazione	6
2.1 Panoramica dello strumento	6
2.2 Installazione	6
2.3 Collegamenti	7
2.3.1 Sonde e alimentazione	7
2.3.2 Ripetitore	8
2.3.3 Comando ON/OFF frigorifero	8
2.3.4 Comando illuminazione display	8
2.4 Installazione sonde	9
2.5 Caricamento carta (non presente vers. NP)	10
2.6 Sostituzione nastro stampante (non presente vers. NP)	10
3 - Manutenzione	11
3.1 Verifiche periodiche	11
3.2 Manutenzione straordinaria	11

Funzioni

4 - Menù utente	11
4.1 Stampa dati memorizzati	11
4.2 Regolazione allarmi	12
4.3 Visualizzazione dati memorizzati	12
4.4 Opzioni	13
4.4.1 Definizione stampa diretta	13
4.4.2 Selezione lingua	13
4.4.3 Luminosità	13
4.4.4 Contrasto	13
4.4.5 Operatore	14
4.4.6 Veicolo	14
4.4.7 Intestazione	14
4.4.8 Scansione	14
4.4.9 Regolazione Orologio	14
4.4.10 Codice chiave	15
4.4.11 Ingressi	15
4.4.12 Porta comunicazione	15
4.5 Servizio SMS	15
5 - GSM	15
6 - Avanzamento Carta	15
7 - Frequenza di registrazione e capacità di memoria	15
8 - Autostart e ExtraTime	16

Apparecchiature e dispositivi associati o associabili

9 - Apparecchiature associate o associabili	17
9.1 Sonde	17
9.2 Modulo GSM - SAT	17
9.3 Ripetitore ottico/acustico	17
9.4 Accessori di fissaggio	17
9.5 Consumabili	17

Appendice

10 - Appendice	17
10.1 Icone display	17
10.2 Decodifica degli allarmi	18
10.3 Problemi e soluzioni	18
10.4 Testi display	19
10.5 Informazioni utili	20

Istruzioni necessarie all'uso

Introduzione

Siamo grati per aver scelto il nostro misuratore e registratore digitale di temperature.

Il Vostro apparecchio è stato prodotto secondo rigidi criteri di qualità.

REC96-20083 è stato progettato come sistema di lettura e registrazione digitale automatica di temperatura nella gamma compresa fra -59.5 e +59.5 °C.

REC96-20083 è dotato di un display LCD 12 x 3 caratteri in cui sono visualizzate le temperature rilevate con una divisione di 0.5 °C oltre che data e ora corrente.

Per la segnalazione di allarmi o guasti in remoto, può essere corredato di ripetitore di allarme di ridotte dimensioni. Le interfacce a disposizione consentono la ricetrasmisione dati e/o messaggi di allarme attraverso la rete telefonica con modulo GSM o al PC, PDA o smartphone con modulo Bluetooth.

Sono disponibili servizi di localizzazione e gestione dati attraverso una piattaforma WEB.

L'identificazione di REC96-20083 è legata ad un codice interno a 8 caratteri univoco e non modificabile. Per un ulteriore riconoscimento è possibile inserire una "intestazione", un nome "operatore" ed una targa "veicolo".

Tutti i parametri di rilevanza metrologica agibili da tastiera sono protetti da password.

REC96-20083 dispone di due canali di misura per i quali è disponibile una memoria di 32.000 registrazioni ciascuno. Superata tale soglia i nuovi dati si limiteranno a cancellare i primi inseriti.

REC96-20083 incorpora una stampante (ad eccezione della versione -NP) con meccanismo ad impatto che usa normale carta cellulosa per una migliore conservazione del rapporto di stampa.

Le operazioni di stampa sono state particolarmente facilitate.

Con una precisa analisi del servizio richiesto al momento dell'installazione, è possibile una impostazione del profilo in modo da ottenere la stampa dei dati desiderati con la sola pressione di un tasto.

Il modello per installazione in cabine (mod. "C") ha una sua naturale collocazione all'interno di uno spazio ISO RADIO, ma sono disponibili ulteriori accessori per il fissaggio a parete, mentre il modello per esterno (mod. "E") è progettato per il fissaggio all'esterno di un cassone frigorifero, grazie agli accessori a corredo.


Il sistema è già stato tarato in laboratorio quindi non sono necessari interventi di regolazione prima dell'avviamento. Il registratore è dotato di un sistema di autocalibrazione che consente una taratura compensante variazioni di temperatura di lavoro dell'apparecchiatura stessa e variazioni della lunghezza del cavo delle sonde.

Tuttavia si ricorda che l'apparecchio è soggetto a verifica periodica con la frequenza raccomandata dalla norma EN13486.

Per eseguire tali verifiche è a disposizione dei concessionari autorizzati un software con cui è anche possibile eseguire regolazioni dello strumento.

Panoramica ed installazione

2.1 - Panoramica dello strumento

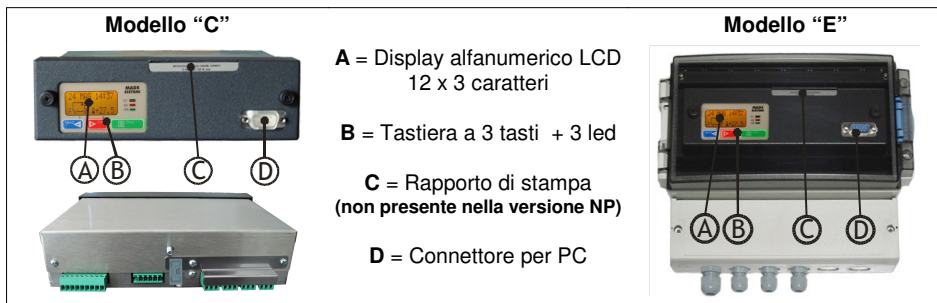

2.2 - Installazione e smontaggio dello strumento

Tutte le operazioni di installazione e messa a punto del REC96-20083 devono necessariamente essere eseguite da personale tecnico specializzato.
Prima di iniziare l'installazione verificare che il dispositivo sia perfettamente funzionante, effettuando almeno un controllo della lettura temperatura, una stampa dati memorizzati e per ultimo la presenza del sigillo di garanzia (fig. 2).

Modello "C"	Modello "E"
Inserire il supporto del termoregistratore nella apposita sede ISO-RADIO e piegare le alette interne per ottenere un solido fissaggio della staffa. Dopo aver effettuato tutti i collegamenti di alimentazione e sonde riportati nel capitolo 2.2, infilare il termoregistratore nel supporto precedentemente fissato fino ad udire un "click di fissaggio".  Per estrarre l'apparecchio, sfilare il pannello frontale, infilare le chiavette come in figura fino alla loro completa inserzione. Tirare verso l'esterno l'intero dispositivo. 	Come prima operazione utilizzare la staffa di fissaggio in dotazione per segnare i punti di fissaggio dei tasselli per muro.  Successivamente fissare la staffa alla parte posteriore del termoregistratore, utilizzando le 4 viti a corredo.  Infine fissare il termoregistratore alla parete. 

--	--

2.3 - Collegamenti

2.3.1 Sonde e alimentazione

La corretta alimentazione del sistema sarà evidenziata dalla accensione della retroilluminazione del display LCD. Ad ogni nuova alimentazione l'apparecchio avvierà una sequenza autodiagnostica per verificare il corretto funzionamento degli elementi interni.

In caso di malfunzionamento lo strumento si bloccherà segnalando l'anomalia constatata.


Una volta installato, il sistema non dovrebbe mai essere disalimentato.

Se tale operazione fosse inevitabile ne seguirebbe il solo blocco temporaneo delle registrazioni senza perdita dei dati già memorizzati.

N.B: La batteria di ritenuta dati, in condizioni ottimali, consente una capacità di conservazione di almeno 2 anni in assenza di alimentazione.

Al ripristino della normale alimentazione il display tornerà a indicare le temperature rilevate e la registrazione riprenderà in modo regolare.


In fig. 2 è indicato come effettuare i collegamenti di alimentazione al dispositivo. La sezione del cavo di alimentazione deve essere di almeno 0,5 mm².

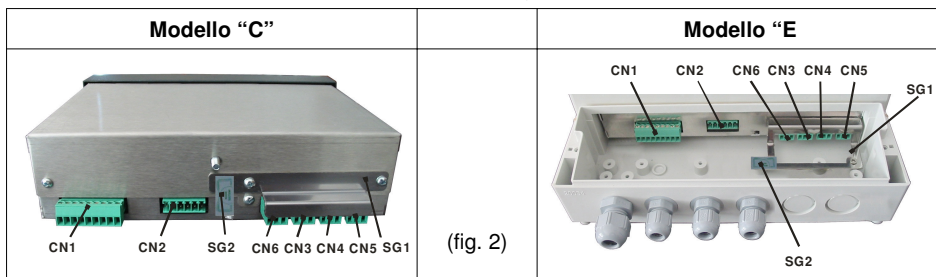

CN1= Connettore di alimentazione e uscite/ingressi
 CN2 = Connettore dispositivo ausiliario trasmissione dati
 CN3= Connettore sonda 1
 CN4= Connettore sonda 2

CN5= Connettore sonda 3
 CN6= Non collegato
 SG1=Sigillo di protezione
 SG2= Sigillo di garanzia

n°	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6
1	Negativo	Positivo	Resistenza	Resistenza	Resistenza	Non coll.
2	Positivo	Negativo	Comune	Comune	Comune	Non coll.
3	Out (+)	CTS	Comune	Comune	Comune	Non coll.
4	Allarme 1	RX				
5	Allarme 2	TX				
6	Input D2 (+)	RTS				
7	Input D2 (-)					
8	Input D1 (+)					
9	Input D1 (-)					

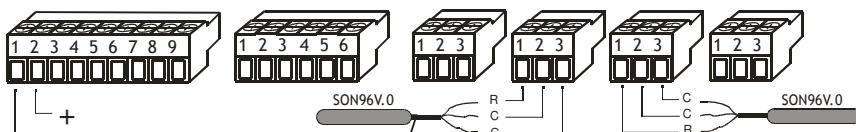

Le sonde non devono mai essere scollegate dal termo-registratore. Se ciò avviene sarà visualizzata la scritta SNC. Il ripristino deve essere scrupolosamente eseguito tenendo presente i vincoli di intervento che riguardano gli strumenti di misura metrici.

Se la temperatura rivelata esce dai limiti di misura, sarà visualizzata la scritta OUT. Con le stesse diciture verranno registrati in memoria entrambi gli eventi.

Le caratteristiche tecniche delle sonde sono riportate nel capitolo "Apparecchiature Associate o Associabili"

E' consigliabile inserire sul cavo di alimentazione un fusibile, come indicato in figura 3.

2.3.2 Ripetitore

Per ottenere la connessione dei ripetitori LED00/01 al REC96-20083 eseguire il collegamento come in fig.3.

2.3.3 Ingresso digitale D1 "Porta"

L'ingresso digitale D1 è dedicato al controllo e registrazione dello stato di un contatto magnetico (normalmente chiuso) installato sulla porta principale del vano frigorifero.

Anche brevi aperture (comunque > 1,5 sec.) non vengono traslasciate in quanto accumulate e quindi memorizzate come unico evento allo scadere dell'intervallo di registrazione in corso. Lo stato della porta è visualizzato su display o stampato sui documenti prodotti con apposita simbologia e/o testo. L'apertura della porta può attivare un allarme acustico, ottico e inviare un SMS se programmato allo scopo. Collegamento illustrato alla fig. 3

2.3.4 Ingresso digitale D2 "Aux"

L'ingresso digitale D2 può essere configurato in quattro modi:

1) Comando "ON/OFF frigorifero": Se il comando viene utilizzato, il registratore deve rimanere alimentato in modo permanente.


Fare riferimento al capitolo "Autostart ed ExtraTime" (pag. 14) per una dettagliata descrizione del servizio.

N.B.: se non collegato viene ignorato automaticamente alla prima alimentazione del registratore. Seguire lo schema di fig.3 per i collegamenti.

2) Comando "Sbrinatori": La presenza di una tensione > 8 Vdc sul comando D2 (input2) indica che è attivo un ciclo di sbrinamento. Anche cicli brevi di sbrinamento non vengono traslasciati in quanto temporaneamente accumulati e quindi memorizzati come unico evento allo scadere dell'intervallo di registrazione in corso. La visualizzazione e la stampa dell'evento sono prodotti con apposita simbologia e/o testo. Collegamento illustrato alla fig. 3

3) Comando "Porta laterale": vedi paragrafo 2.2.3 (ingresso digitale D1).

4) Comando "Servizi": vedi paragrafo 2.2.4 (ingresso digitale D2).

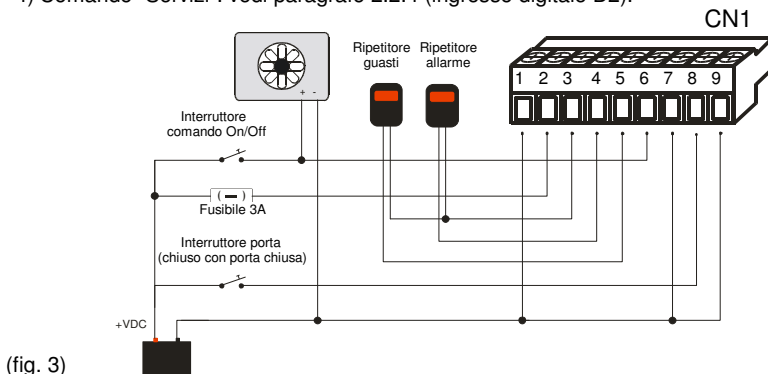


(fig. 3)


2.4 - Installazione sonde

Modo d'installazione delle sonde del Termo-registratore REC96-20083 in relazione al D.M. 493 del 25/09/95 (abrogato).


Cassone frigorifero con paratia

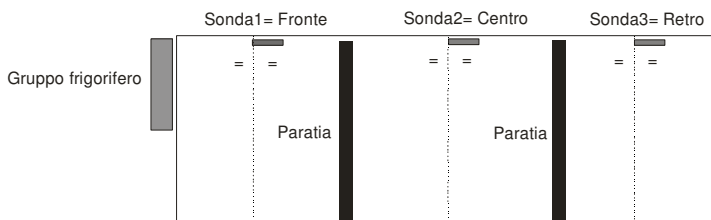

Cassone frigorifero con lunghezza inferiore a 10 m.

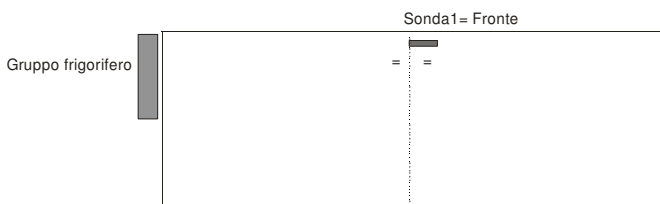

Cassone frigorifero con lunghezza maggiore di 10 m.

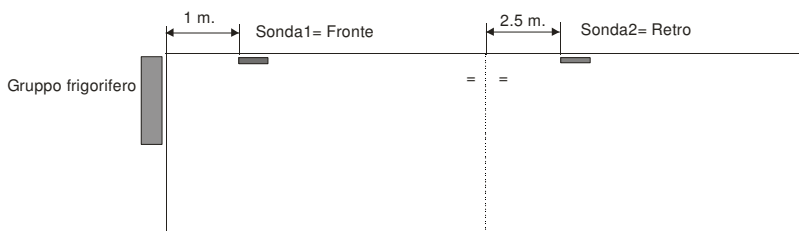



Accorgimenti generali sull'installazione delle sonde

- Non posizionare le sonde a diretto contatto con le pareti
- Evitare che oggetti si interpongano tra l'uscita dell'aria dall'evaporatore e le sonde
- Orientare il lato più sensibile della sonda (lato metallico) verso il gruppo frigorifero.

2.5 - Caricamento carta

Sfilare il pannello frontale e inserire la carta nella fessura "A".

Premere il tasto ◀ per fare avanzare la carta fino ad ottenerne circa 10 cm. in uscita dalla fessura superiore.

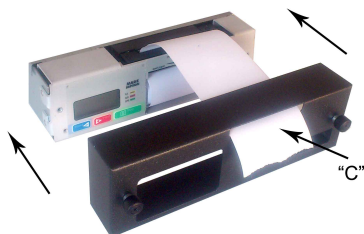
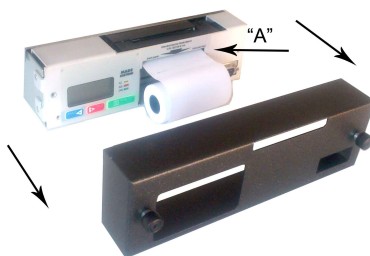


Infilare la carta nella fessura "C" e ricollocare il pannello nella posizione iniziale. Tagliare la carta in eccesso. (per ulteriori dettagli su "Avanzamento carta" vedi Cap. 7)

**Manuale non
riproducibile**

2.6 - Sostituzione nastro stampante

Sfilare il pannello frontale e il rotolo della carta.

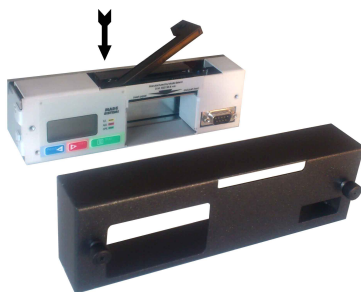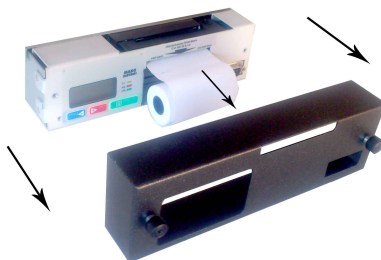

Premere nel punto indicato dalla freccia. (nel nastro è indicata la scritta "PUSH")
Collocare il nuovo nastro nella medesima posizione del precedente.
Prima di reinserire il rotolo carta, accendere il termo-registratore e premere il tasto ◀ di avanzamento carta per circa 10 sec. per portare il nastro in trazione.
Successivamente procedere al caricamento del rotolo della carta.

Manutenzione

In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti la manutenzione necessaria all'apparecchiatura e taluni consigli per evitare inconvenienti.

3.1 – Verifiche periodiche

Ogni anno è raccomandata la verifica periodica dello strumento e delle sonde a corredo (EN12830) a partire dalla data di prima installazione o se del caso, dalla data dell'ultima sostituzione delle sonde o ripristino dei sigilli di garanzia.

L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato può essere effettuato dalla ditta costruttrice o da un suo concessionario autorizzato secondo le procedure indicate nella norma EN13486. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a corredo. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo indicante il nome del costruttore e/o del concessionario autorizzato che l'ha eseguita e la data di scadenza della verifica medesima.

3.2 - Manutenzione straordinaria

I dati relativi alle misure effettuate sono conservati per almeno due anni in memoria alimentata da batteria al litio anche in assenza di alimentazione esterna.

I dati di configurazione e l'orologio sono conservati in un modulo elettronico dotato di batteria propria della durata di circa 5 anni.

Dopo un lungo periodo di inattività è comunque consigliabile provvedere alla loro sostituzione in occasione della successiva revisione periodica.

Eventuali guasti o anomalie del sistema vengono segnalati sul display con le diciture riportate nel cap. "Problemi e soluzioni".

Funzioni

Menu utente

In questo capitolo vengono trattate le varie funzioni disponibili all'utente per l'utilizzo del REC96-20083. I parametri di calibrazione dello strumento sono modificabili solamente dal Costruttore

Accesso Utente: al menù utente si accede tenendo premuto per qualche secondo il tasto  dopodiché apparirà la scritta "STAMPA DATI". Successivamente premere il tasto ◀ o ▶ per raggiungere la sezione desiderata e  per entrare nel menu richiesto

All'interno del menu principale, nel caso non sia premuto nessun tasto, il sistema si riavvia automaticamente dopo 8 sec., mentre all'interno dei menu utente il tempo di riavvio è di 20 sec.

In caso di errore di programmazione, non è possibile ripristinare né i valori precedenti, né i parametri predefiniti del costruttore.

Accesso Password: dopo aver effettuato la procedura di "Accesso Utente", inserire la password di accesso. (fornita di fabbrica: 0000)

4.1 - Stampa dati

Menu per la stampa dati. La risoluzione di richiesta stampa è giornaliera.

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura 'Accesso Utente'. (pag. 12)

Selezionare il giorno di inizio stampa mediante i tasti ◀ o ▶ e premere il tasto . Ripetere l'operazione per impostare il giorno di fine stampa. Successivamente i tasti

◀ o ▶ consentiranno di impostare la stampa in modo testo o grafico, con dati in formato reale o con media mobile di 3° ordine e nella direzione avanti o indietro .

N.B.: In tutti i casi in cui il tasto  non identifica una scelta, verrà considerata come modo predefinito.

N.B: In modo grafico il primo giorno stampato sarà quello più recente.

N.B.: Premere per 2 sec. il tasto  per interrompere la stampa.

A fine stampa sono riportate le "Eccezioni" o "Note" se presenti

4.2 - Regolazione allarmi (SET ALLARMI)

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura 'Accesso Utente'. (pag. 12)

Consente l'esclusione della sola suoneria interna ("Acustico ") e la regolazione del ritardo di attivazione dell'allarme ("Ritardo Att.") tra 0 e 600sec (10min) in 60 passi da 10 secondi..

Permette la regolazione manuale o predefinita in bande del livello del termostato di allarme MAX. e di allarme MIN. per singolo canale ("C1 (Retro) ", "C2 (Fronte) ") o simultaneamente (Monocomparto) .

Il reinserimento dell'allarme acustico é automatico a ogni uscita dai menu di regolazione e/o abilitazione termostati.

Con "Reg.Manuale", i termostati sono regolabili nell'intervallo compreso tra +59°C e -59°C o presettabili nelle bande:

Banda	Temp. max	Temp. min
Surgelato	-15 °C	-35 °C
Congelato	-7 °C	-10 °C
Refrigerato	+4 °C	-1 °C
Ventilato	+35 °C	0 °C

NB: I termostati sono escludibili .

NOTE: Nel caso la suoneria interna venga tenuta abilitata, sarà possibile tacitarla tramite uno qualsiasi dei 3 tasti posizionati sul pannello frontale.

Non è possibile la tacitazione del segnalatore remoto se configurato come ripetitore di allarme termostato. Gli allarmi locali e remoti vengono ripristinati ogni qualvolta si riavvia il sistema.

Esiste comunque una tacitazione automatica del solo allarme interno dopo un periodo di 5 min.

La suoneria interna è sempre abilitata per segnalazioni di guasto.

4.3 - Visualizzazione dati memorizzati (VISIONE DATI)

Consente la sola visualizzazione sul display dei dati memorizzati nell'archivio storico o se presenti i dati relativi agli ultimi 8 eventi di guasto.

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura 'Accesso Utente'. (pag. 12)

Con la presenza di almeno un guasto viene abilitata l'opzione '(-) GUASTI'

Accedendo all'archivio "Guasti" è possibile il ripristino del led Giallo di memoria 'FLT' solo se l'anomalia non è in corso "Enn Res (+)". (Enn = codice allarme, vedi tabella guasti).

La risoluzione di ricerca è giornaliera per i dati conservati in "(+) Storico".

Selezionare il giorno desiderato mediante i tasti ◀ o ▶ e poi premere il tasto .

Per iniziare la consultazione agire sui tasti ◀ o ▶ . I dati memorizzati verranno visualizzati in relazione all'intervallo di registrazione impostato. Se il tasto ◀ o ▶ viene tenuto premuto per

più di 1 sec. inizierà lo scorrimento automatico dei dati con aumento graduale della velocità di avanzamento. Premere il tasto  per uscire dal menu.

Note: il menu guasti viene visualizzato e reso disponibile solo se è avvenuto almeno un evento anomalo. In questo caso viene attivata l'opzione reset memoria ultimo guasto che ripristina il led giallo lampeggiante e trasferisce l'evento in una coda circolare di max 8 guasti con propria data/ora, numero progressivo e codice di allarme. Il logger guasti può essere cancellato solo in officina autorizzata o in fabbrica. Con ripetuti eventi dello stesso tipo viene memorizzato solo il primo. Con ripetuti eventi di tipo diverso vengono tutti memorizzati ma solo l'ultimo presentato al reset.

4.4 – Opzioni

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura 'Accesso Utente'. (pag. 12)

4.4.1 - Definizione stampa diretta (Def.Stampa.D)

Set di comandi che permette di eseguire la funzione di stampa con la sola pressione del un tasto ► (Print). Sono disponibili 4 diversi modi di stampa immediata. La definizione del profilo di stampa diretta viene completato con la scelta del MODO di rappresentazione dei dati in valore "Reale ", con cui i dati sono presentati nel loro valore "Reale" misurato o "Medio" con cui i dati vengono riprodotti dopo l'elaborazione con il metodo della Media Mobile di Ordine 3°, dello STILE di stampa in formato "Testo" o "Grafico" e della DIREZIONE "Avanti" e "Indietro". La selezione è guidata presentando solo i menu compatibili alla precedente definizione del Tipo di stampa diretta.

Stampa per missione: Vengono stampati i dati memorizzati dal marcatore di "inizio missione" fino all'ora corrente o a "fine missione" se presente. Tale marcatore è impostabile attraverso l'operazione di stampa.

Stampa ultimo periodo: Vengono stampati tutti i dati contenuti nel periodo scelto tra un minimo di 3 ore ad un massimo di 21 giorni. Il valore è impostabile da tastiera.

Stampa da ultima accensione: verrà prodotta la stampa dei dati a partire dall'ultima volta in cui il registratore e/o il frigorifero è stato acceso.

Stampa scontrino di consegna: Selezionando questa opzione viene stampata la temperatura nel preciso momento della richiesta. In alternativa è possibile richiedere la stampa della lista delle ultime 62 consegne eseguite.

4.4.2 - Scelta lingua (Sel. Lingua)

Consente la scelta del linguaggio operativo tra 5 idiomi quali: Italiano ("Italiano"), Inglese ("English"), Francese (Française), Tedesco (Deutsch), Spagnolo ("Espanol").

Tutti i testi rappresentati su display, carta o SMS saranno convertiti nel linguaggio prescelto ad eccezione della stringa di 12 caratteri relativa al "Veicolo", "Operatore" e "Intestazione" .

4.4.3 - Luminosità

Consente la regolazione di "Luminosità" ovvero della intensità della retroilluminazione del display in 15 livelli

4.4.4 - Contrasto

Consente la regolazione del "Contrasto" ovvero l'aggiustamento dell'angolo di visuale in 15 passi tra + 30° e -30°.

4.4.5 - Operatore

Si accede al menù per inserire un ulteriore codice di riconoscimento (es: nome del proprietario) con un massimo di 12 caratteri.

Il codice "Operatore" è evidenziato in ogni operazione di stampa o messaggio SMS.

I tasti ◀ o ▶ consentono di ricercare il carattere desiderato, mentre con il tasto  si conferma la scelta. Dopo l'inserimento del dodicesimo carattere premere "(Salva) (+)". (▶).

4.4.6 - Veicolo

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura "Accesso Password". (pag. 12)

Si accede al menù per inserire un ulteriore codice di riconoscimento (es: targa o numero telaio) con un massimo di 12 caratteri.

Il codice veicolo è evidenziato in ogni operazione di stampa, scarico dati o messaggio SMS.

I tasti ◀ o ▶ consentono di ricercare il carattere desiderato, mentre con il tasto  si conferma la scelta. Dopo l'inserimento del dodicesimo carattere premere "(Salva) (+)". (▶).

4.4.7 - Intestazione

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura "Accesso Password". (pag. 12)

Si accede al menù per inserire una ulteriore identificazione dello strumento (es: nome dell'azienda) con un massimo di 12 caratteri.

Il codice intestazione è riportato come titolo ad ogni scontrino di stampa.. Il font è a doppia larghezza per una migliore lettura del testo.

I tasti ◀ o ▶ consentono di ricercare il carattere desiderato, mentre con il tasto  si conferma la scelta. Dopo l'inserimento del dodicesimo carattere premere "(Salva) (+)". (▶).

PS: modificando l'intestazione da software PC è possibile inserire fino a 16 caratteri.

4.4.8 - Scansione

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura "Accesso Password". (pag. 12)

Si accede al menù per modificare l'intervallo di registrazione del dispositivo.

I tasti ◀ o ▶ consentono di ricercare il valore desiderato, mentre con il tasto  si conferma la scelta. Dopo l'inserimento dell'intervallo desiderato premere "(Salva) (+)". (▶).

Consultare "Frequenza di registrazione e capacità di memoria" per la conformità alle norme del servizio (pag 15).

4.4.9 – Regolazione Orologio (Reg.Orologio)

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura "Accesso Password". (pag. 12)

Si accede al menù per aggiornare l'ora e la data del termo-registratore. L'operazione può essere eseguita solo una volta al giorno. In tale menu è anche impostabile il cambio ora legale/solare automatico e la fascia oraria di appartenenza (WEST- CEST – EEST). Impostare CEST(+1) per Italia.

4.4.10 – Codice chiave (Cod. Chiave)

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura “Accesso Password”. (pag. 12)

Si accede al menù per modificare la password di accesso ai menu protetti.

I tasti ◀ o ▶ consentono di ricercare il valore desiderato, mentre con il tasto  si conferma la scelta. Dopo l'inserimento del quarto carattere premere "(Salva) (+)". (▶).

4.4.11 – Ingressi

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura “Accesso Password”. (pag. 12)

Consente di abilitare o disabilitare gli ingressi di temperatura e digitali del termo-registratore. Ad ogni canale è possibile associare un testo (selezionabile tra gli 8 pre-memorizzati) che identifica la posizione della sonda di temperatura.

Per una ulteriore spiegazione sugli ingressi digitali, fare riferimento al paragrafo 2.3.3 e 2.3.4.

L'ingresso digitale D1 se configurato come “frigor” o “Sbrina.” provoca solo visualizzazioni sul display, mentre se la scelta è come “Pr..Lato” o “Servizi” attiva anche allarmi ed invio SMS (se abilitato).

Tutti le segnalazioni di D1 e D2 sono registrate in memoria e solo la modifica di D1 (come Pr.Lato o Servizi) provoca la cancellazione della memoria.

	Ingressi temperatura	Ingresso D1 “Frigor.” / “Sbrina.”	“Pr.Lato”	Ingresso D2 “Servizi”	“Porta”
Visualizzazione display	si	si		si	si
Allarme locale	si	no		si	si
Registrazione in memoria	si	si		si	si
Invio SMS (opzionale)	si	no		si	si
Cancellazione Memoria	no	si		si	no

4.4.12 – Porta Comunicazione (Porta Com.)

Per entrare in questa sezione eseguire la procedura “Accesso Password”. (pag. 12)

Imposta il protocollo di trasmissione della stringa dati sulla porta seriale del termo-registratore quando al dispositivo viene associata una periferica di trasmissione dati (es: modulo GSM o bluetooth).

4.8 - Servizio SMS

Menù visibile solo se è stato attivato il modulo GSM (vedi punto 4.4.12 o PC) . Esso abilita l'invio di SMS attraverso la rete (se collegato al modulo GSM opzionale).

Si rimanda al manuale d'uso specifico per maggiori dettagli.

GSM

Gestione di un eventuale modulo GSM per invio di SMS per segnalazioni di allarme e/o dati memorizzati. Il modulo aggiuntivo deve essere collegato al connettore “CN2” (fig.2) mediante apposito cavo (fornito con modulo). Caratteristiche del servizio GSM: (parametri impostati da PC)

1. n° 3 numeri telefonici in uscita (per invio SMS): (oppure 2 internazionali da 16 cifre)
2. Chiave PIN
3. Invio SMS per allarme termostato , consegna, servizi
4. Invio SMS per registrazione ogni scan time
5. Invio SMS per guasto REC96-20083
6. Gestione degli SMS pendenti (fino a nuovo evento) e controllo in linea presenza modulo GSM, ogni 30 sec.

7. Servizio CALL CENTER per scarico dati e/o configurazione servizio.
8. Ricezione SMS per impostazione servizio e richiesta stato.

Avanzamento carta

Con la pressione del tasto ◀ (Feed) per circa 2 secondi si ottiene l'avanzamento carta fino al rilascio del tasto medesimo.

Frequenza di registrazione e capacità di memoria

In accordo alla norma EN12830 che impone la conservazione dei dati per almeno 1 anno, é opportuno ricordare che dovrà essere eseguito uno scarico dati con PC entro il numero dei giorni indicato in tabella in relazione all'intervallo di registrazione programmata.

Intervallo di registrazione	n° giorni in memoria
1 min	21 giorni
2 min	44 giorni
5 min	111 giorni
10 min	221 giorni
15 min	329 giorni
20 min	434 giorni
30 min *	639 giorni
60 min *	1210 giorni

* = Non permesso se il termoregistratore è in configurazione 92/1/CEE

NB: La capacità di registrazione é espressa in numero di giorni ANCHE NON CONSECUTIVI.

Dopo il numero dei giorni indicato in tabella viene eseguita l'operazione di ricircolo con la perdita progressiva dei dati più vecchi. Da notare che con intervallo di 20, 30, 60 minuti si avrà sempre in memoria più di un anno di dati registrati.

NB: L'intervallo di registrazione deve essere scelto in base alla durata tipica dei viaggi secondo la tabella seguente: (estratta da EN12830)

Intervallo di registrazione	Durata del viaggio
5 min	<= 1 giorno
15 min	<= 7 giorni
20 / 30 min	> 7 giorni

IN.B.: I cambio dell'intervallo di registrazione comporta la cancellazione totale dei dati in memoria. E' consigliato uno scarico dei dati acquisiti per una conservazione in archivio.

Autostart ed ExtraTime

Il registratore dispone del comando denominato "AUTOSTART" il cui uso permette l'ottimizzazione della memoria con il registratore sempre alimentato e la gestione degli allarmi durante le fasi operative o di parcheggio.

Collegando il comando all'unità frigorifera si potrà telecomandare l'avviamento del registratore e l'abilitazione degli allarmi in corrispondenza della accensione della unità stessa.

Con l'unità frigorifero "ON" si visualizza lo stato con un  a fianco dell'icona dell'automezzo, si avvia istantaneamente la registrazione e vengono abilitati gli allarmi termostati e il servizio SMS.

Con unità frigorifero "OFF" si visualizza lo stato con un  a fianco dell'icona dell'automezzo e inizia il conteggio di un ritardo di 240 min. allo scadere del quale, se l'unità è ancora spenta, si blocca il processo di registrazione, vengono disattivati gli allarmi termostati e il servizio SMS (se attivo) visualizzando nel contempo la scritta "stop Regist." sul display. Nella fase di stop viene altresì inibito il comando di stampa diretta mentre rimane abilitato l'accesso ai menu utente.

In questo stato sarà comunque possibile avviare il registratore premendo il tasto rosso "► PRINT" per più di 2 sec.

NB: tutti gli allarmi di guasto grave rimangono sempre attivi.

NB: Il comando di AUTOSTART é opzionale per cui, se non collegato, verrà automaticamente ignorato al momento della prima alimentazione del termoregistratore. Il comando é riabilitato automaticamente se collegato a unità accesa per più di 1 sec.

Apparecchiature e dispositivi associati o associabili

In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti le eventuali apparecchiature comunemente collegabili al REC96-20083. Tutte le seguenti apparecchiature devono essere installate da personale tecnico di assistenza.

	Codice/Foto	Descrizione
9.1	SON96V.007MT	Sonda PT 100 a 3 fili - 6 x 50 mm – sigillata - 7 mt.
	SON96V.011MT	Sonda PT 100 a 3 fili - 6 x 50 mm – sigillata - 11 mt.
	SON96V.015MT	Sonda PT 100 a 3 fili - 6 x 50 mm – sigillata - 15 mt.
	SON96V.020MT	Sonda PT 100 a 3 fili - 6 x 50 mm – sigillata - 20 mt.
9.2	GSM01MD	Modulo GSM
	BT01MD	Modulo Bluetooth
9.3		Ripetitori ottico - acustici remoti.
		Ripetitore allarme di potenza
9.4		Staffa di fissaggio a parete (per mod. "E")
		Supporto per montaggio sottopancia (per mod. "C")
9.5	CAR57D30	Rotolo di carta per stampante
	ERC09	Nastro inchiostro per modulo stampante

**Manuale non
riproducibile**

Supporto per montaggio sottopancia (per mod. "C")


Appendice

In questo capitolo (al punto 10.1) viene riportata una panoramica di tutte le icone visualizzate sul display e degli eventuali guasti che possono presentarsi sul REC96-20083, con a fianco le possibili soluzioni al problema intercorso.

Sono inoltre riportate le avvertenze da osservare per un corretto funzionamento ed uso.

10.1 - Icone display

In funzionamento normale, il display alfanumerico presenta l'ora/data corrente, nella parte superiore, la sagoma di un automezzo sulla parte sinistra, e lo "stato" strumento sulla parte destra. La risoluzione può essere impostata a 0,1 °C da PC per la sola lettura.

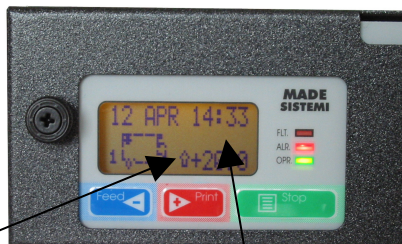

Icone Termostato

Area Icone

Segue la codifica delle icone che possono presentarsi nel display in fase di funzionamento:

Area Icone				Icone termostato	
	Servizio SMS attivo		Porta aperta (D2)		Allarme termostato alto
	Modulo GSM attivo		Blocco termostati		Allarme termostato basso
	Modulo GSM in avaria		Registratore in pausa		Termostato attivato
	Cicalino escluso		Allarme remoto		
	Call Center connesso		Autostart ON (frigorifero ON)		
	PC connesso		ExtraTime (frigorifero OFF)		
	Dispositivo trasmissione dati in avaria		Sbrinator attivo		
	Dispositivo trasmissione dati connesso		Servizi		
			Batteria scarica		
				Icone automezzo	
					Fronte Sonda 1
					Centro Sonda 2
					Retro Sonda 3
					Porta aperta Ingresso D1

10.2 - Decodifica degli allarmi

LED OPR (verde)	LED FLT (giallo)	LED ALR (rosso)	EVENTO
Spento	Spento	*	REGISTRATORE IN BLOCCO O NON ALIMENTATO
Spento	Acceso fisso	*	REGISTRATORE IN BLOCCO
Lampeggiante	Lampeggiante veloce	*	AVARIA IN CORSO Batteria memoria in esaurimento o guasta o anomalia 1 e/o 2 sonde.
Lampeggiante	Acceso fisso	*	FUORI SERVIZIO
Lampeggiante	Lampeggiante lento	*	Tensione alimentazione insufficiente MEMORIA DI GUASTO Indicazione di avvenuta anomalia

Lampeggiante	Accesso 2 Sec. più 3 beep	*	Errore comunicazione con PC o Stampante
*	*	accesso	Allarme termostato canale 1 e/o 2

Legenda: * = indifferente

10.3 - Problemi e soluzioni

Guasto	Problema	Soluzione
Il display non si accende	Registratore in blocco o non alimentato.	Controllare alimentazione e collegamenti
La stampante non stampa		Controllare presenza carta, nastro stampante e alimentazione

10.4 - Testi display – Codice allarme

Testo display	Codice	Descrizione	Soluzione
Err. rete GSM		Connessione GSM fallita	Verificare copertura rete GSM e attivazione carta/servizi SIM
Err. Stampa		Stampante guasta	Riferire al concessionario
Errore 232		Errore comunicazione con PC o moduli opzionali connessi.	Controllare cavo REC96 / PC e alimentazioni
Errore Dati		Dati in memoria corrotti	Resettare registratore
Errore GSM. nn		Guasto modulo o connessione	Controllare cavo e ritentare attivazione servizio SMS
Guasto BAT.SC	E096	Batteria memoria in esaurimento o guasta.	Non disalimentare! Scaricare i dati e riferire al concessionario
Guasto BAT.LL	E097		
Guasto TEC.01	E001	Orologio da aggiornare o in blocco!	Resettare registratore
Guasto TEC.02	E002	Errore interrupt	Resettare registratore
Guasto TEC.04	E004	Guasto linee input/output - RS232	Resettare registratore
Guasto TEC.05	E005	Anomalia convertitore analogico/digitale	Resettare registratore
Guasto TEC.06	E006	Comunicazione LCD difettosa	Resettare registratore
Guasto TEC.07	E007	Dati di configurazione corrotti	Resettare registratore
Guasto TEC.08	E008	RAM Dati guasta.	Resettare registratore
Guasto TEC.99	E099	Batteria orologio scarica	Resettare registratore
Guasto VCC.LL	E098	Tensione alimentazione Insufficiente	Controllare tensione di alimentazione.
OUT		Sonda corrispondente fuori range	
SNC - (can. 1)	E015	Sonda corrispondente guasta o non collegata	
SNC - (can. 2)	E012	Sonda corrispondente guasta o non collegata	
Stop Regist.		Registrazione bloccata	

10.5 - Informazioni utili

ATTENZIONE !	In caso di rottura del display LCD può fuoriuscirne una sostanza leggermente corrosiva. Evitare il contatto con pelle ed occhi.
ATTENZIONE !	Un uso improprio del sistema comporta una totale annullamento di garanzia ed una acquisizione dati non attendibile.
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA	Durata di 18 mesi. I prodotti che si rivelino difettosi entro tale periodo saranno prontamente sostituiti o riparati. Non sono garantiti i danni provocati da un cattivo uso. Copertura su invecchiamento o guasti precoci e difetti di fabbricazione di parti meccaniche o elettriche. Le sonde (SON96V.0) associate hanno garanzia di 6 mesi, mentre la stampante interna, 12 mesi.
NOTA	Si declina ogni responsabilità riguardo a perdita di dati in memoria.
NOTA	Resetare il registratore significa togliere alimentazione per circa 10 sec. e successivamente riattivarlo.
NOTA	Normalmente il led 'OPR' lampeggia con una frequenza di 1 sec. Quando è in corso una registrazione il led lampeggia ad una frequenza maggiore. Durante tale operazione sono disabilitate tutte le funzioni di tastiera e stampa.
ATTENZIONE ! 	Non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata. Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa. Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente. La pubblica amministrazione ed i produttori di RAEE sono impiegati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali. La legge punisce con opportune sanzioni che smaltisce abusivamente i RAEE.
NOTA	Manuale in revisione: aggiornato al 04/01/2016 Release software: R005/04.01A

Prodotto da

MADE SISTEMI

Sede operativa: via Berlinguer, 59 - Forlimpopoli (Forlì) - Italy
www.madesistemi.it - Tel. +39 (0543) 743127